

Техническая Спецификация

Лот №1 Трехточечный нутромер 100 мм. -125 мм

Точность измерения: 0,01 мм.

От 100 мм-125 мм.

Функциональное предназначение: Предназначен для измерения внутренних диаметров деталей, глухих и сквозных отверстий.

Физическое описание: Металлический стержень с ручкой для регулировки, с ЖК дисплеем. С расположенными в основании тремя выдвижными цилиндрами.




Лот №2 Трехточечный нутромер 125 мм. -150 мм

Точность измерения: 0,01 мм.

От 125 мм-150 мм.

Функциональное предназначение: Предназначен для измерения внутренних диаметров деталей, глухих и сквозных отверстий.

Физическое описание: Металлический стержень с ручкой для регулировки, с ЖК дисплеем. С расположенными в основании тремя выдвижными цилиндрами.

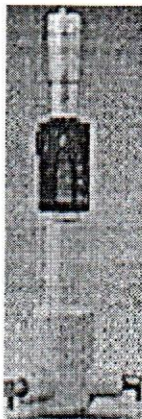

Общее требование к 1 и 2 лотам:

Нутромеры должны комплектоваться оригинальным боксом и установочным кольцом - 125 мм.

Ценовое предложение должно содержать техническую спецификацию с указанием марки, модели страны производителя.

Обязательное предоставление фотографии предлагаемого товара вместе с ценовым предложением (в заявке на участие в закупке).

Нутромеры должны иметь сертификат соответствия (паспорт, формуляр) не менее чем со сроком калибровки 12 месяцев.

Обязательное предоставления технического описания по руководству работы к поставляемым нутромерам.

ИНЖЕНЕР Цеха ГРУБЕ А.В. 